



中华人民共和国医药行业标准

YY 0636.2—2008/ISO 10079-2:1999
代替 YY 0101—1993

医用吸引设备 第 2 部分：人工驱动吸引设备

Medical suction equipment—Part 2: Manually powered suction equipment

(ISO 10079-2:1999, IDT)

2008-04-25 发布

2009-12-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

中华人民共和国医药
行 业 标 准
医用吸引设备
第 2 部分：人工驱动吸引设备
YY 0636.2—2008/ISO 10079-2:1999

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字
2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷

*

书号：155066·2-18982

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前 言

YY 0636《医用吸引设备》分为三个部分：

- 第 1 部分：电动吸引设备 安全要求；
- 第 2 部分：人工驱动吸引设备；
- 第 3 部分：以负压或压力源为动力的吸引设备。

本部分为 YY 0636 的第 2 部分。

本部分等同采用 ISO 10079-2:1999《医用吸引设备 第 2 部分：人工驱动吸引设备》(英文版)。

本部分与 ISO 10079-2:1999 的主要差异：删除国际标准的前言。

本部分代替 YY 0101—1993《脚踏吸引器》。

本部分与 YY 0101—1993 的主要差异：

- 根据 ISO 10079-2:1999 重新起草。本部分章条编号与 ISO 10079-2:1999 章条编号完全一致且内容对应。
- 更名为“医用吸引设备 第 2 部分：人工驱动吸引设备”。

本部分的附录 A 为规范性附录，附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本部分由全国麻醉呼吸设备标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：上海医疗器械工业(集团)公司医用吸引器厂。

本部分主要起草人：徐慈方、王建琴、邵国梁。


本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- YY 0101—1993；
- WS 2-173—1973。

医用吸引设备 第 2 部分：人工驱动吸引设备

1 范围

YY 0636 的本部分规定了用于咽部吸引的人工驱动吸引设备的安全和性能要求。包括脚踏、手动或两者并用的吸引设备(参见图 1)。YY 0636 的本部分的范围包括可以与电气设备相组合的非电动吸引设备。

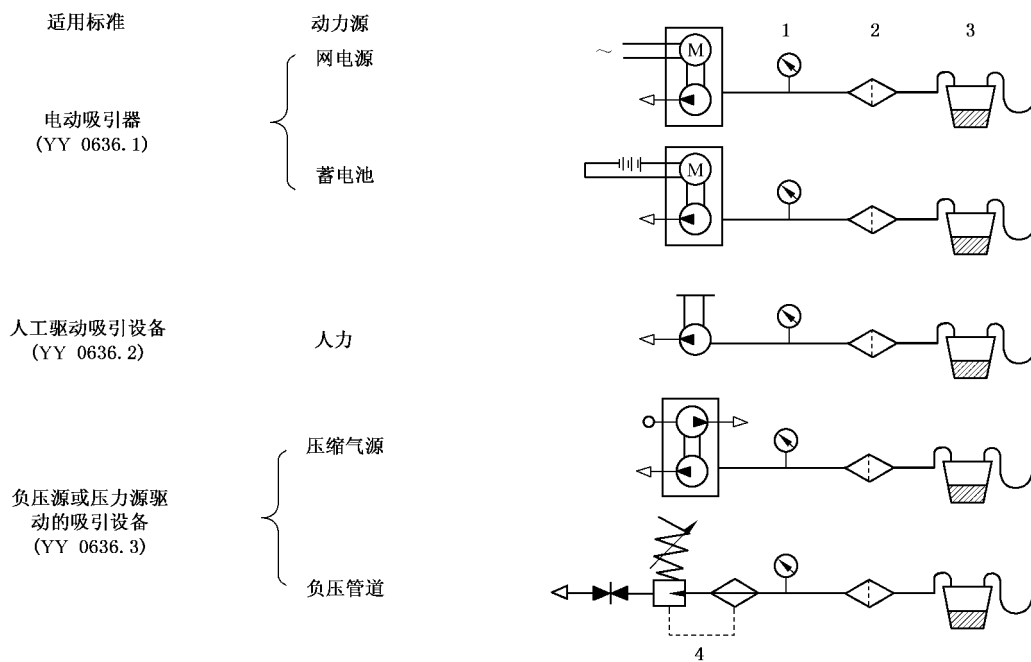

- 1——负压指示器；
- 2——过滤器；
- 3——收集容器；
- 4——负压调节器。

注 1：YY 0636 的第 1 部分适用于网电源和蓄电池驱动的吸引设备，YY 0636 的第 2 部分适用于人工驱动吸引设备，YY 0636 的第 3 部分适用于负压或压力源驱动的吸引设备。

注 2：图上所示的各部件不一定是 YY 0636 的本部分所要求必须具备的。

注 3：图上所示的吸引设备仅是一个实例，而实际的装置可能还包括其他图上未画出的设置和部件。

图 1 吸引设备的示意图

YY 0636 的本部分不适用于 YY 0636. 1 中讨论的由网电源供电或电池驱动的电动吸引设备；也不适用于 YY 0636. 3 中讨论的以负压或压力源作动力的吸引设备；也不适用于以下设备：

- a) 中央动力系统(采用负压/压缩气体发生装置)，车辆和建筑物的管道系统，以及墙壁连接器；
- b) 导液管，引流管，刮除器和吸引头；
- c) 注射器；
- d) 牙科吸引设备；