

UDC 615.477.87
C 36



中华人民共和国国家标准

GB 11234—1995

宫腔形宫内节育器

Uterine cavity form intra-uterine devices

1995-02-28 发布

1995-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

宫腔形宫内节育器

Uterine cavity form intra-uterine devices

GB 11234—1995

代替 GB 11234—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了宫腔形宫内节育器(以下简称宫形器)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于宫腔形含铜和不含铜宫内节育器。该产品放置于妇女子宫腔内作避孕用。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 4240 不锈钢丝

GB 4342 金属显微维氏硬度试验方法

GB 5121.1 铜化学分析方法 电解法测定铜量

YY/T 0149 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

3 产品分类

3.1 宫形器分为含铜和不含铜二种。

3.2 宫形器的型式和基本尺寸应符合图1、图2及表1的规定。

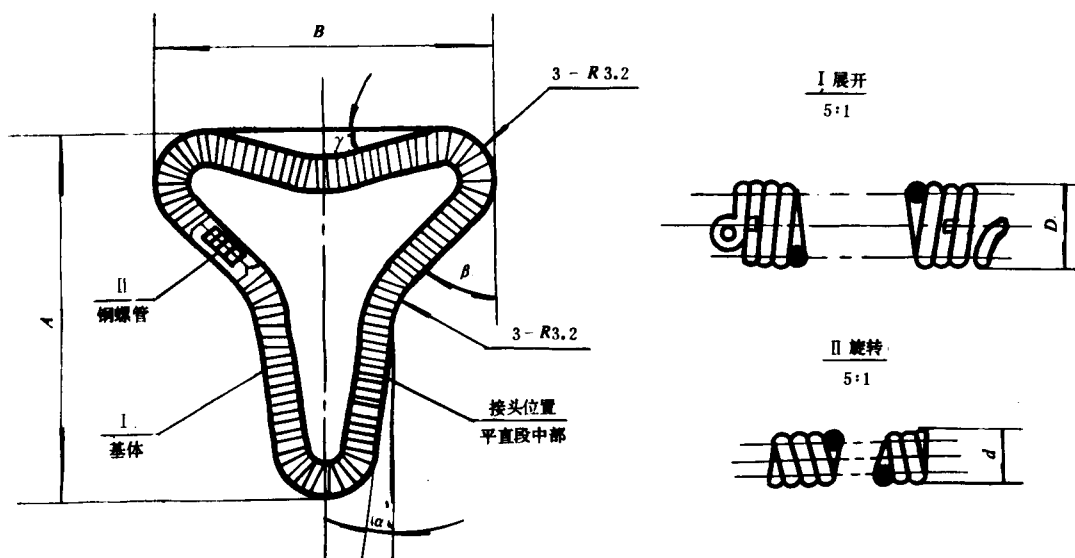


图1 含铜宫内节育器